

മകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
കിഴക്കേ
ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം
വേലൂർ

കേരള ഗവണ്മെന്റ്
ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ
ജന & Palliative Care Centre

Incorporated
SHAKKELAPAM
Ran. Board of Reg.
ID - 000 - 10000

മനുഷ്യ ജീവനും
ജീവനും



വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 കുടുംബ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം
 വേലൂർ



വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 കുടുംബ
 ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം
 വേലൂർ



വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
കുടുംബ
ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം
വേലൂർ



ജീവിത ശൈലി
രോഗങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്
എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും
9 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ


പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, വേലൂർ
ഫാർമസിയൽ ലഭ്യമായ മരുന്നുകൾ

Sl. No.	Medicine Name	Quantity	Sl. No.	Medicine Name	Quantity
1	Amoxicillin	1000	11	Paracetamol	1000
2	Aspirin	1000	12	Penicillin	1000
3	Chloroquine	1000	13	Metformin	1000
4	Diazepam	1000	14	Insulin	1000
5	Diclofenac	1000	15	Levodopa	1000
6	Dobutamine	1000	16	Clonidine	1000
7	Doxycycline	1000	17	Hydrochlorothiazide	1000
8	Erythromycin	1000	18	Isosorbide	1000
9	Fluconazole	1000	19	Nifedipine	1000
10	Flunitrazepam	1000	20	Verapamil	1000

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് /
ജനറൽ കേന്ദ്രം സംയുക്ത
ശിശു ചികിത്സാ കേന്ദ്രം
CHILD CARE CENTRE

PRE ASSESSMENT ROOM

പ്രീ അസസ്സ്മെന്റ് റൂം

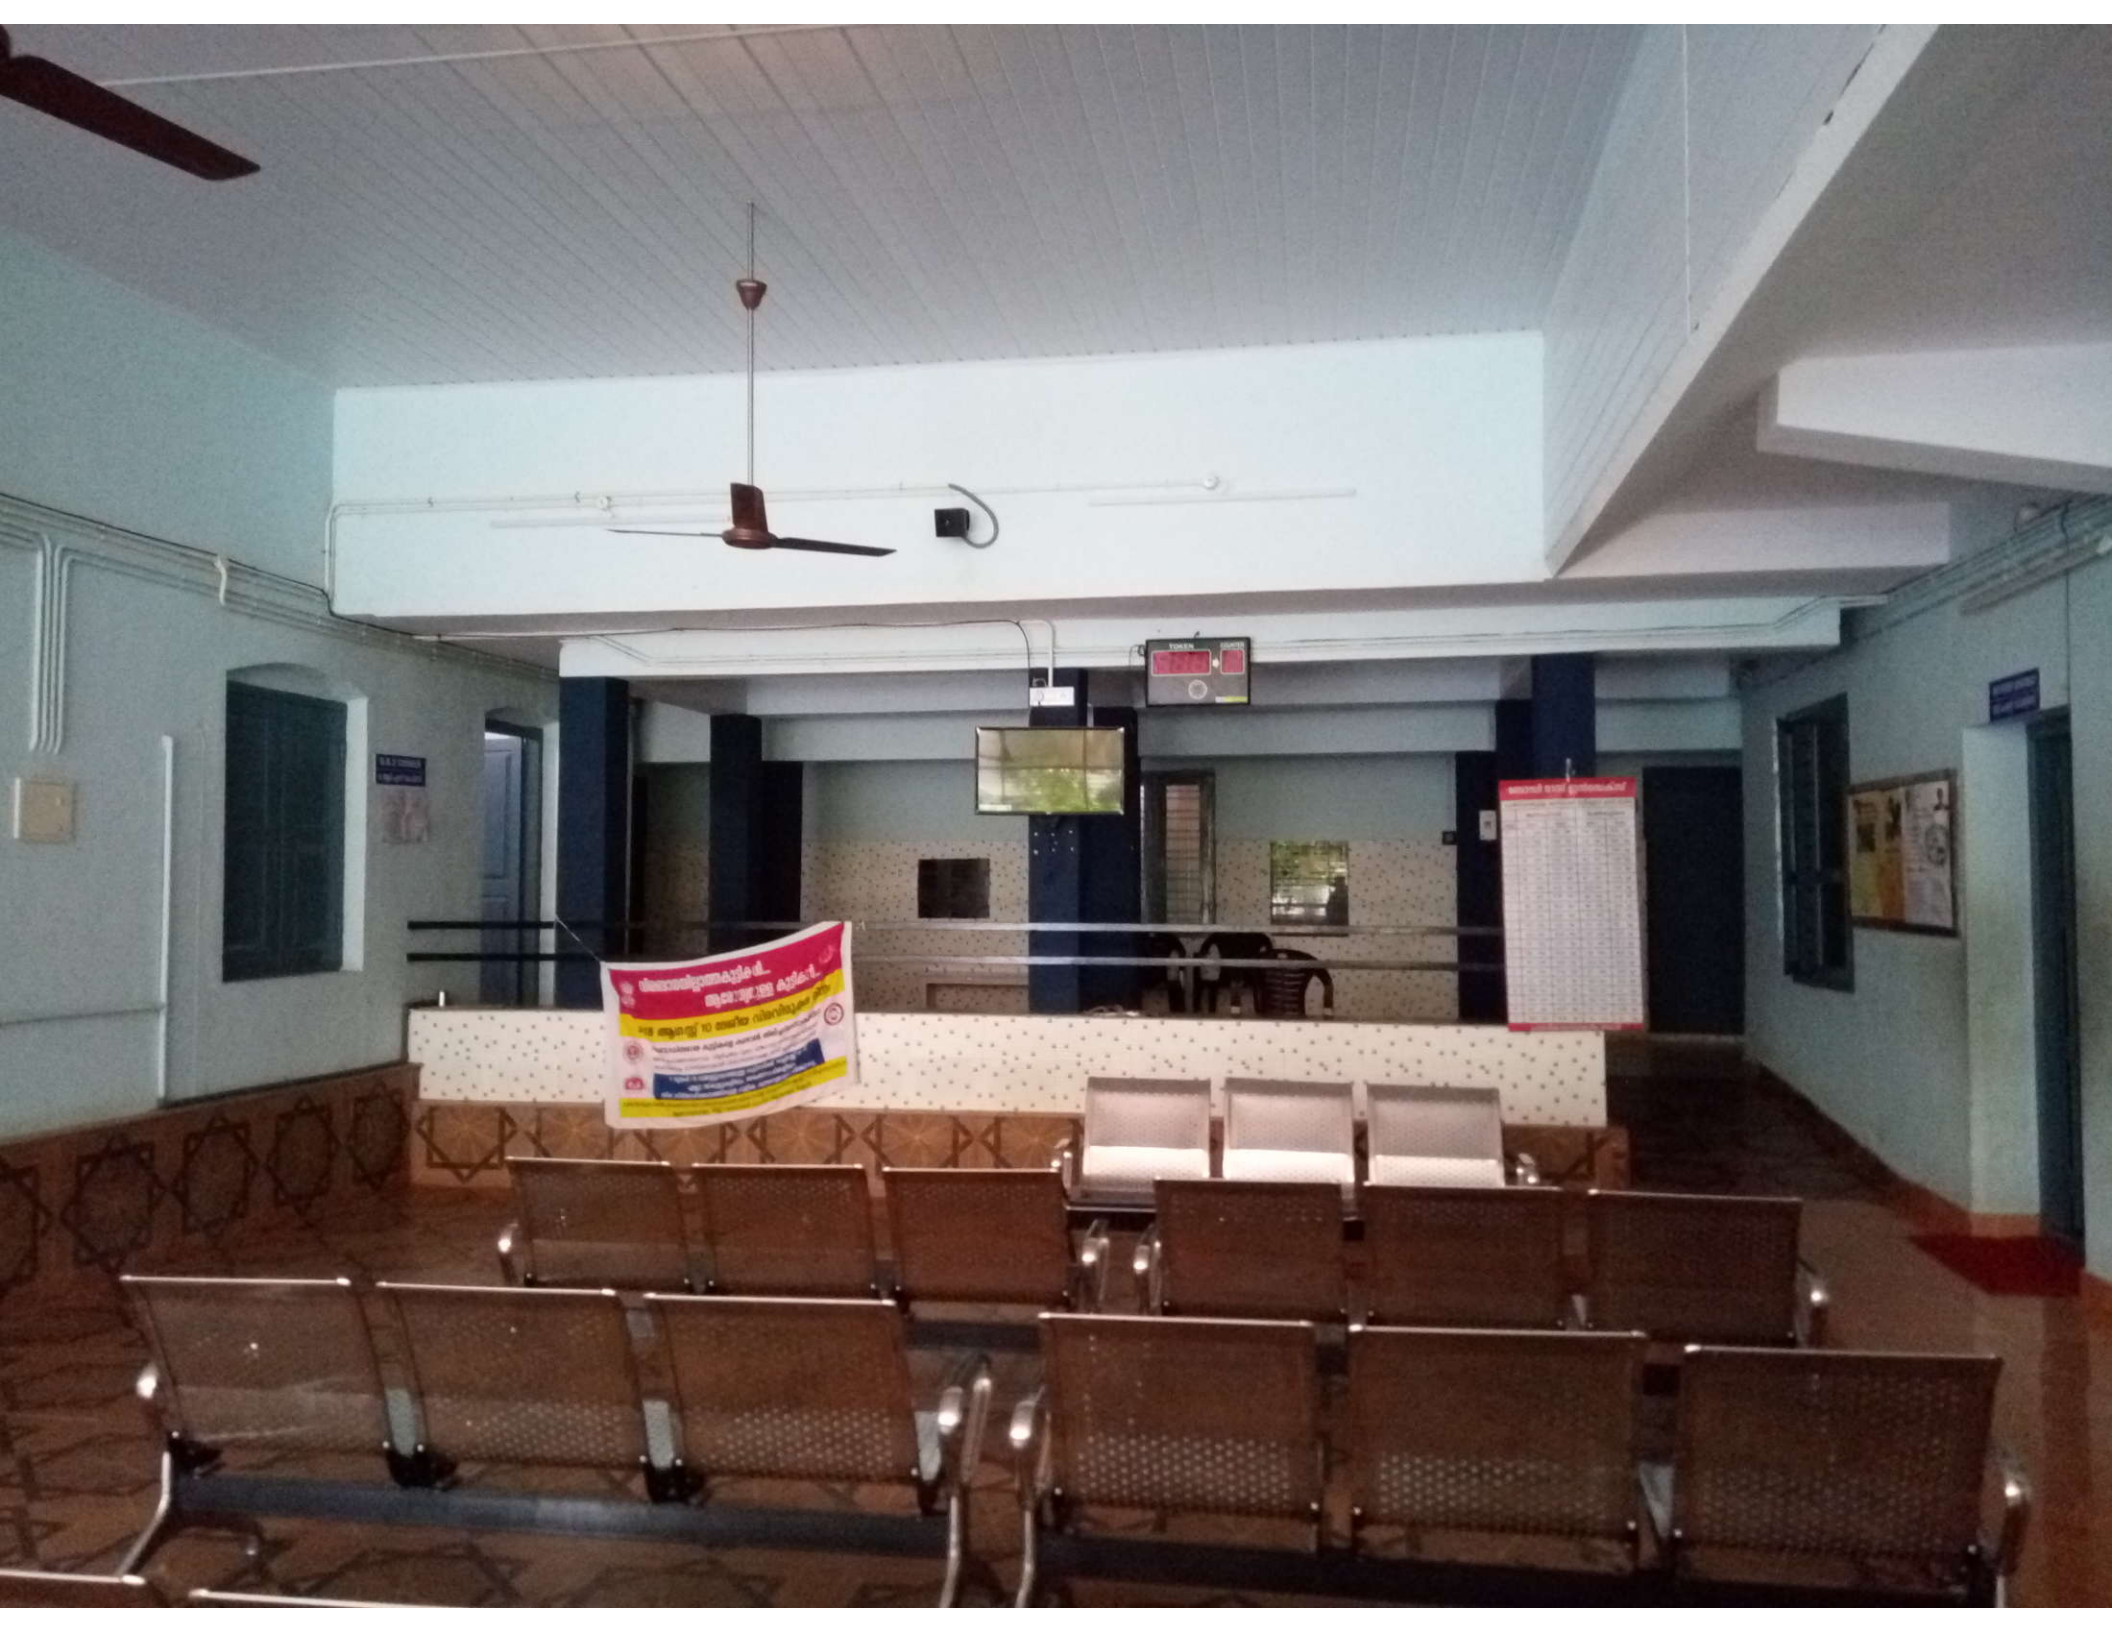

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ
സംസാരം
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ
സംസാരം
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ
സംസാരം

കാലപ്പട്ടിക

ക്രമ നമ്പർ	പേര്	തീയതി
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



OP REGISTRATION COUNTER
ഒ.പി. രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടർ

എൽ.പി. രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടർ
കൗണ്ടർ സൗകര്യം
രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടർ
സൗകര്യം

കൗണ്ടർ സൗകര്യം
രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടർ
സൗകര്യം

2023-2024
സെപ്റ്റംബർ മുതൽ
ഒക്ടോബർ വരെ
പി.പി. രജിസ്ട്രേഷൻ
സൗകര്യം

പി.പി. രജിസ്ട്രേഷൻ സൗകര്യം
രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടർ
സൗകര്യം

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31									





Haier
Inspired Living
REFRIGERATOR
REFRIGERADOR
ХОЛІДНИК
REFRIGÉRATEUR
البريد



EEG MAC
3

Digital 3 Channels Electrocardiograph

WARNING
Residual electrical hazard if used in
the presence of flammable anesthetics.
Residual electrical hazard if used in
the presence of flammable anesthetics.

CAUTION
Electro shock hazard
Do not remove leads
Make servicing or qualified service personnel
perform servicing of this device.

WARNING
For continued production approval
The manufacturer's instructions must be read
before using this device.