

നമ്പർ. എം.എസ്.പി 3/52162/13/ആ.വ.ഡ.

ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,  
തിരുവനന്തപുരം. തീയതി. 04/11/2013.

**ദർഘാസ് പരസ്യം ദീർഘിപ്പിക്കൽ നോട്ടീസ്**

സൂചന : ദർഘാസ് പരസ്യതീയതി 31/08/2013 -ഉം 05/10/2013-ഉം.

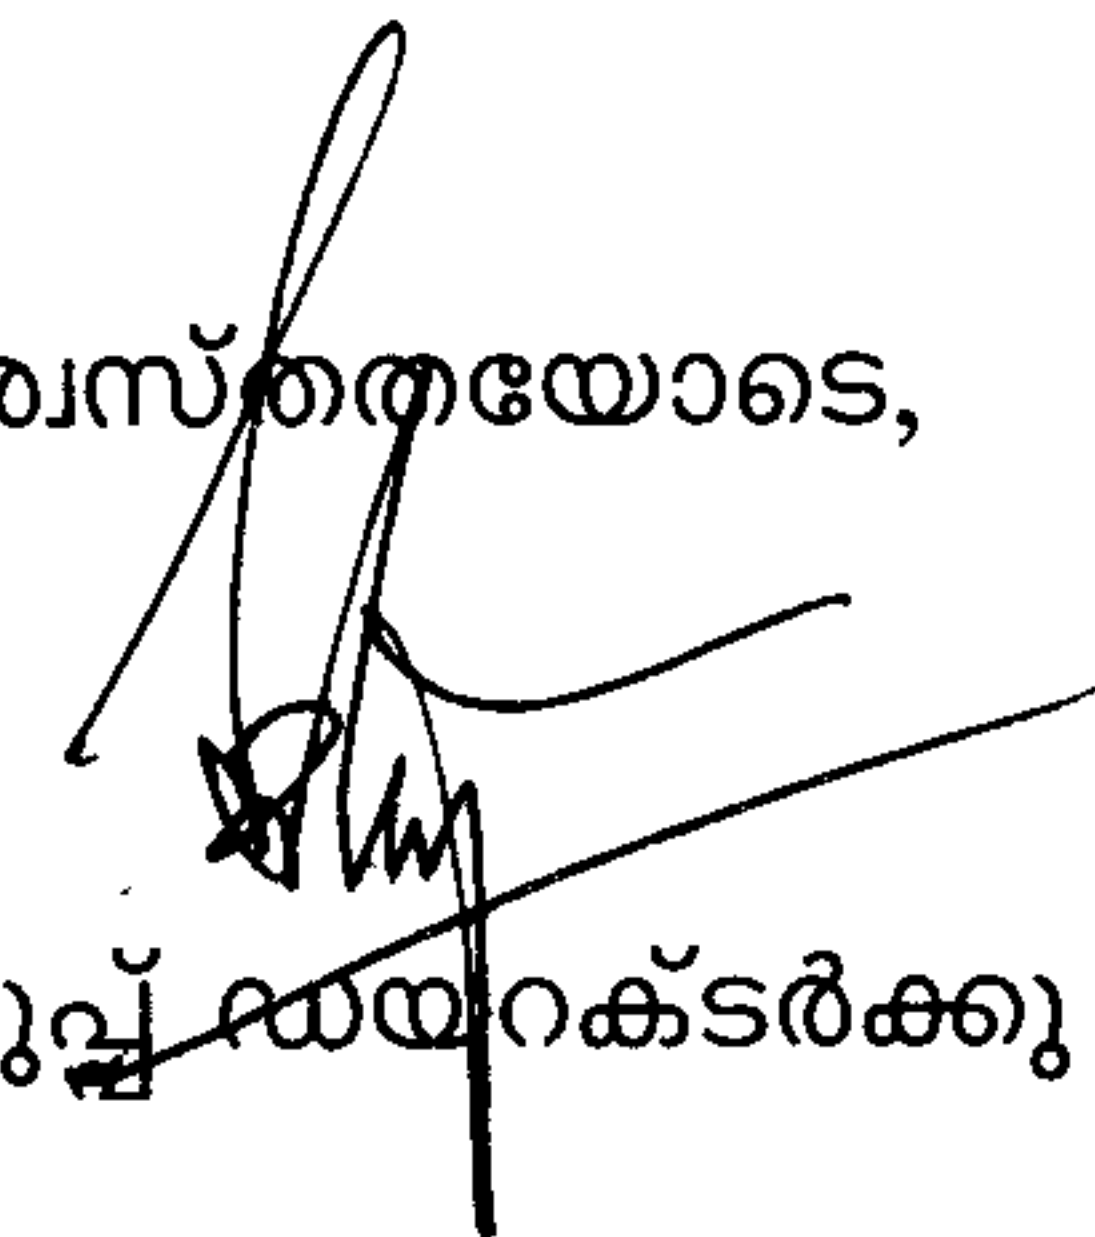
ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ താഴെപ്പറയുന്ന ദർഘാസുകൾ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും, സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും, തുറക്കുന്ന തീയതിയും ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റു നിബന്ധനകൾക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരുത്തുന്നതല്ല.

ക്രമ നമ്പർ	ഉപകരണത്തിന്റെ പേര്	എണ്ണം	ദർഘാസ് നമ്പർ	അസ്സൽ ദർഘാസ്	പകർപ്പിന്റെ വില
1	സ്പൈനൽ ഡികംബ്രേഷൻ സിസ്റ്റം	2	6/13-14	3000 + 5% വാറ്റ്	1500 + 5% വാറ്റ്
2	വൈബ്രേറ്റർ	1	7/13-14	600 + 5% വാറ്റ്	300 + 5% വാറ്റ്
3	ഷോൾഡർ സി.പി.എം (കണ്ടിന്യൂസ് പാസീവ് മോഷൻ)	2	8/13-14	2250 + 5% വാറ്റ്	1150 + 5% വാറ്റ്

ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 25/11/2013 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണി വരെ

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 26/11/2013 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണി വരെ

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി : 27/11/2013 രാവിലെ 11 മണിയ്ക്ക്

വിശ്വസ്തതയോടെ,  


ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്കു വേണ്ടി

- പകർപ്പ് :
1. ഡയറക്ടർ, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്
  2. സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് പ്രസ്, തിരുവനന്തപുരം
  3. നോട്ടീസ് ബോർഡ്
  4. വെബ്സൈറ്റ് ഓഫ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ